



封口直径与深度表 操作手册

封口直径表

型号:

GP-GG-CD-001

用途:

本表用于测量气雾阀的封口直径。



校正方法:

用校正块(图 1)确保表的读数和校正块的稳合。必要时松开螺丝'A' (图 2)调整量表, 效正后上紧螺丝。



图 1: 校正块

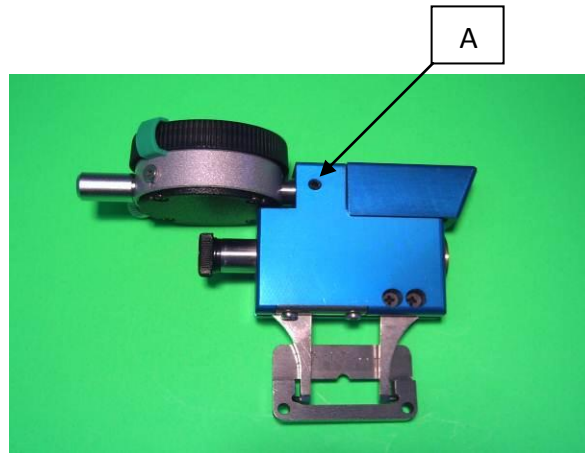


图 2: 校正方法

测量方法:

如图 3, 轻按按钮 'B', 将测量脚放进气雾阀内, 放开按钮 'B', 然后轻转仪表直到有稳定的读数。

按钮 B



图 3: 使用方法

封口深度表

型号:

GP-GG-CH-001

用途:

本表用于测量气雾阀的封口深度。

校正方法:

用校正块(图 4)确保表的读数和校正块的稳合。必要时松螺丝'C'(图 5)，然后调整量表，效正后记上紧螺丝。

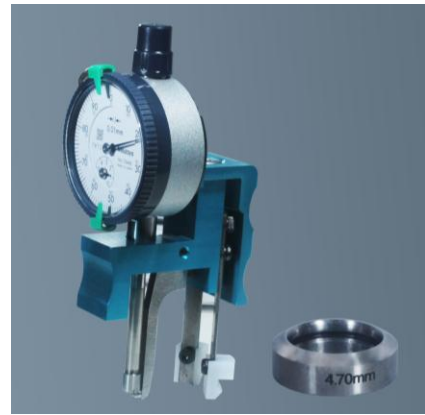


图 4: 校正块

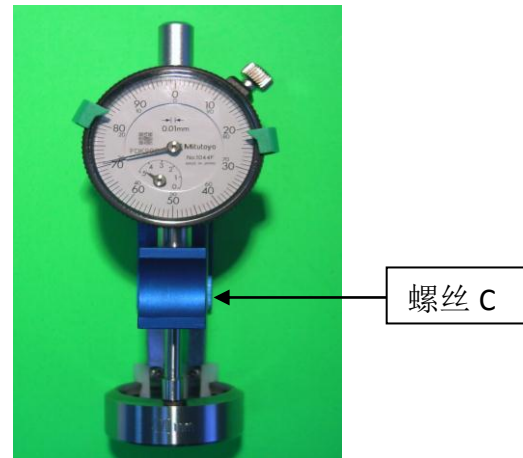


图 5: 校正方法

测量方法:

如图 6，倾侧仪表，先把测量脚 'D' 放入气雾阀内，然后往下轻推把测量脚 'E' 稳定的扣住气雾阀，读数。取出仪表，先倾侧仪表把测量脚 'E' 拉出，然后取出。

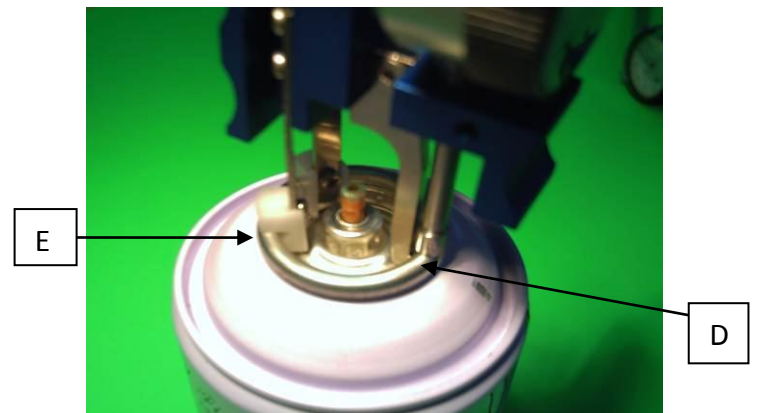


图 6: 使用方法